

Utiliser le Bluetooth sur un Mac

A partir de la version 1.22, la version Mac du logiciel Biostim permet de se connecter à :

- Capteur BioMoov. Ce capteur se fixe sur un plateau de proprioception et permet de travailler sur l'ajustement postural anticipateur
- Sondes vaginales Emy et Perifit
- BlueBack Physio. Biofeedback du muscle transverse

Prérequis

Disposer d'une version de Biostim fonctionnelle, et installée dans le répertoire utilisateur et non sur le bureau

Problème


Si un clic sur le logo  produit une erreur, la démarche est la suivante

Etape 1 : donner les droits en exécution au programme MacBLE

Ouvrir un terminal


Se placer dans le répertoire appData. Commande : **cd BiostimData/appData**

Donner les droits en exécution au programme. Commande : **chmod a+x MacBLE**

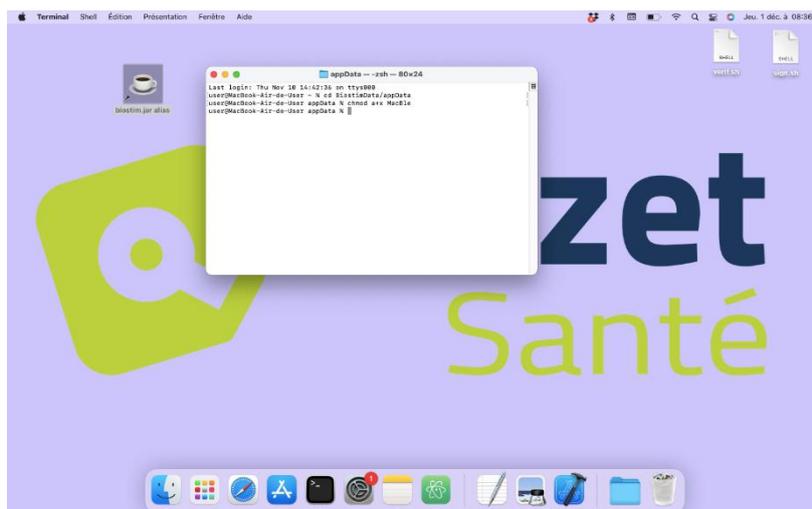

Etape 2 : autoriser Java à utiliser le BlueTooth


Ouvrir les préférences systèmes

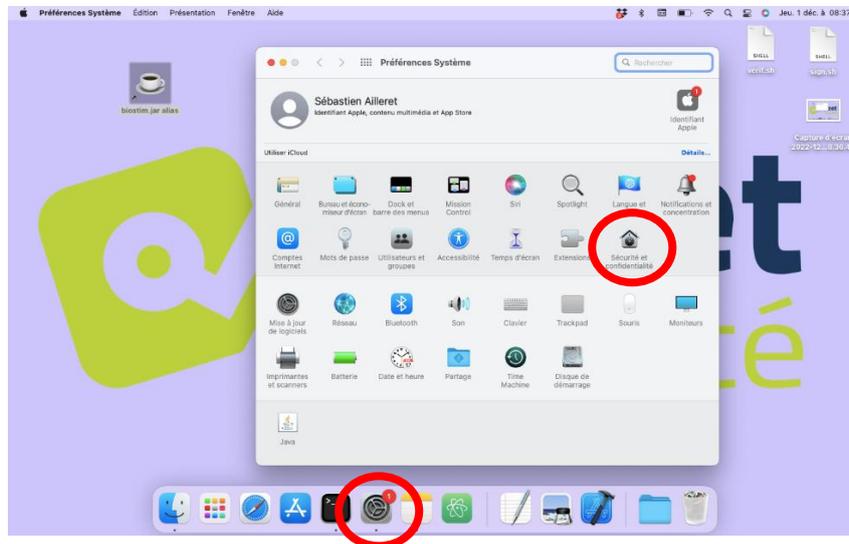

Dans les préférences système, ouvrir « Sécurité et Confidentialité ».


Sélectionner l'onglet Confidentialité, puis Bluetooth dans la liste déroulante

Appuyer sur « + » pour donner des autorisations à un nouveau programme

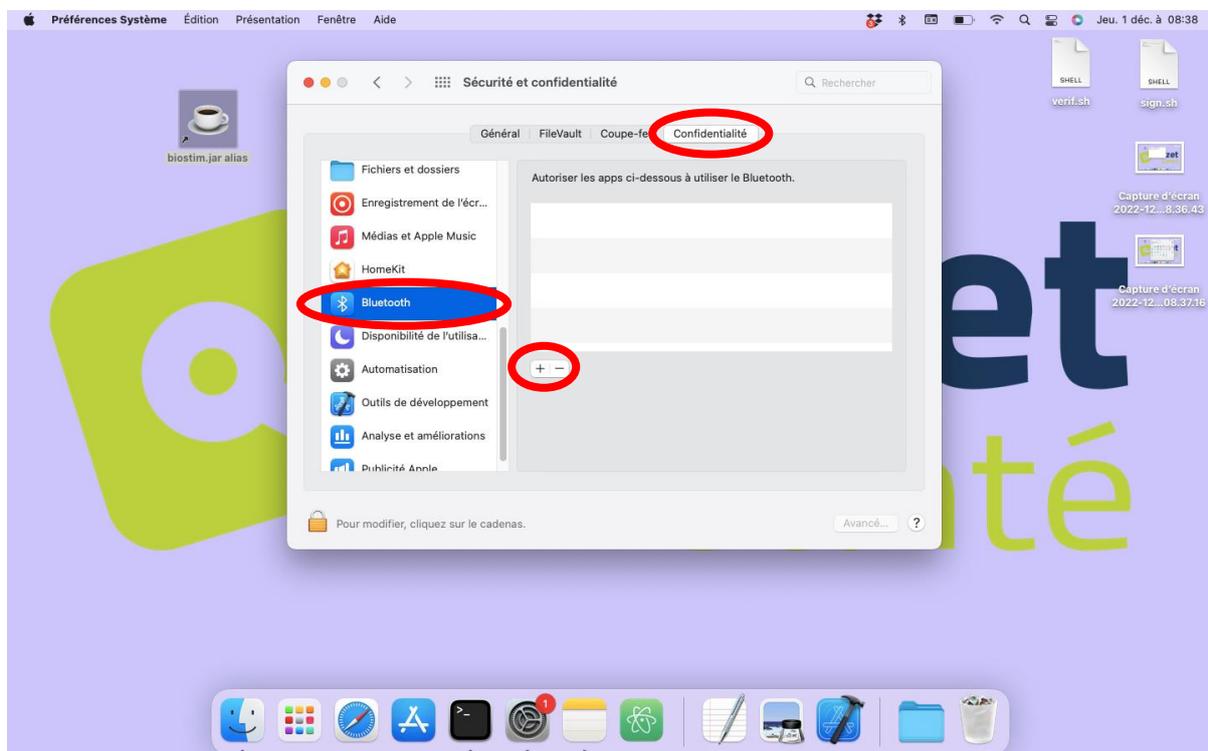

Sélectionner le programme JavaLauncher, qui se trouve dans :

Votre Mac / Système / Bibliothèque / CoreServices

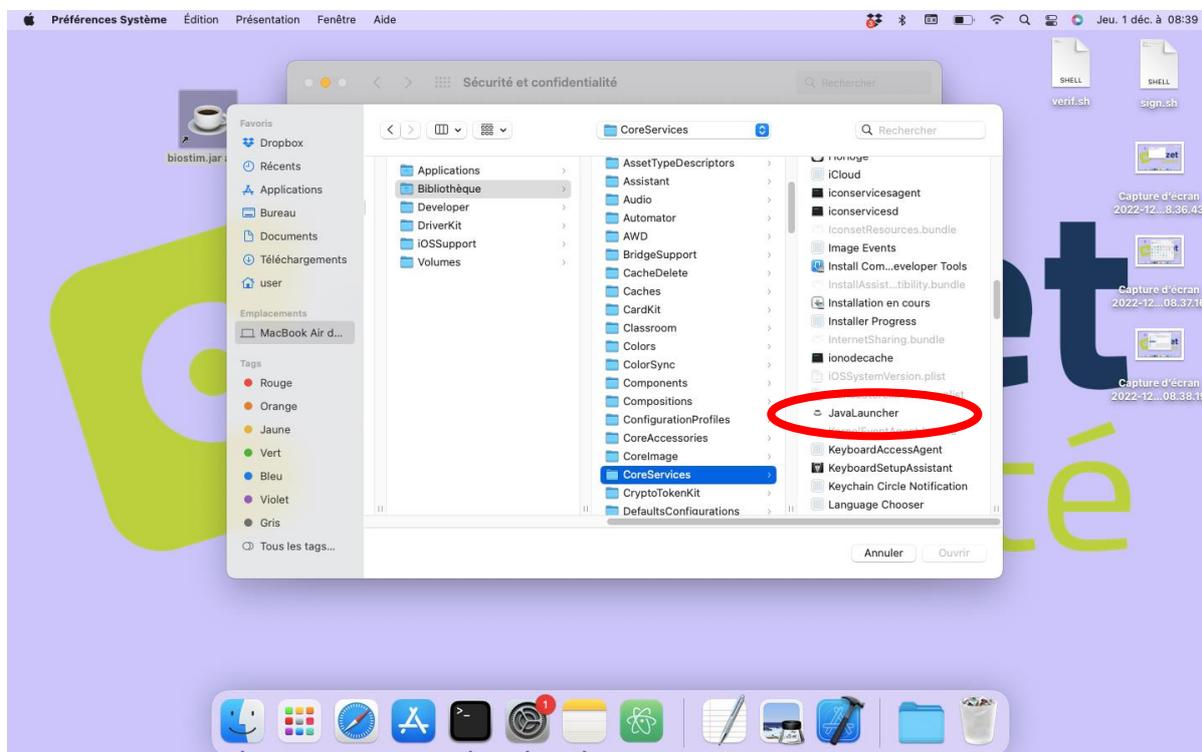

Les droits sont accordés, relancer le biostim pour profiter du BlueTooth

